

Protokoll Kita-Ausschuss 20.05.2021

Datum/Zeit: 20.05.2021 / 18:00 – 19:30 Uhr

Ort: Telefonkonferenz

Protokoll: Simone H.

1. Begrüßung

2. Aktuelles vom Träger

- a) Testungen Kita-Kinder
 - Kinder können **freiwillig** getestet werden (bis Ende Juni)
 - Morgen bekommen die Erzieher die Infos, danach können sie ab Dienstag nach Pfingsten an die Eltern ausgegeben haben
 - Teststrategie kommt vom Land, nicht von der Gemeinde
 - Theres W.: welche Tests werden genutzt? – siehe Fotos im Anhang
 - Theres W.: Inwieweit werden die Tests nachverfolgt? – Fr. Schulze: bei pos. Test muss PCR-Test folgen, bitte beachten Sie die Informationen auf der Veröffentlichung
 - Fr. Mandel: Es handelt sich um Nasen-Tests
 - Andreas K.: Wird eine Dokumentation erfolgen und muss das Ergebnis mitgeteilt werden?
 - Fr. Mandel: Die Ausgabe wird gegen Unterschrift erfolgen; eine Rückmeldung der Testergebnisse ist bisher nicht erforderlich
 - Pro Familie stehen 10 Tests zur Verfügung
- b) Reduzierung Stunden
 - Im letzten Ausschuss wurde besprochen, dass die Eltern aktuell aufgrund der verkürzten Öffnungszeiten die Betreuungszeit reduzieren können
 - Sobald wieder die Rahmenhygienepläne ausgesetzt sind und die normalen Öffnungszeiten gelten, können die Stunden ohne großen Aufwand auf den aktuellen Stand erhöht werden
- c) Wann kann der Parkplatz in der D23 genutzt werden?
 - Fr. Schulze nimmt es mit
 - Fr. Mandel: Genehmigung für 2. Einfahrt muss erfolgen, hier ist nicht klar, wie der Stand ist
- d) Besteht die Möglichkeit, den Neubau vor Umzug zu besichtigen?
 - Fr. Mandel: Ja, es wird gerade ein Konzept dazu erstellt (siehe dazu auch unter Punkt „Sonstiges“ – Stand Planung Elternversammlungen)

3. Aktuelles vom Förderverein

- Keine aktuellen Neuigkeiten

4. Aktuelles vom KKEB

- Entfällt

5. WSG-Team

- Erste Testessen haben stattgefunden
- Bitte das Erzieher-Team über den Ablauf informieren
- Ausgefüllte Fragebögen gingen an Christina V.

6. Teamzusammensetzung

- Siehe Anhang
- Name Nestchen 1: Laufenten – bestehend aus Kobold- und Wichtelgruppen
- Name Nestchen 2: Rennschnecken – bestehend aus Wichtelkindern
- Name Nestchen 3: Flitzeflöhe – bestehend aus Koboldkindern
- Am 21.05. werden Zettel in den Schränken liegen, welches Kind in welche Gruppe kommen wird
- Auch die anderen Gruppen bekommen neue Namen – diese stehen aber noch nicht fest

7. Sonstiges

a) Stichtag Einschulung

- Die Planung in der Kita erfolgt aufgrund Stichtag 30.06.
- Die Zusammenarbeit mit der Schule ist sehr eng
- Rückstellungsanträge werden eher befürwortet
- Linda H.: bis wann muss ein Rückstellungsantrag gestellt werden?
- Fr. Mandel und Andreas K.: bis Schuleintritt, angemeldet werden müssen die Kinder aber auf jeden Fall in der Schule, weil die Schulpflicht eintritt
- Linda H.: Was passiert, wenn der Stichtag tatsächlich nicht bis zum Sommer zurückgesetzt wird mit den Kindern die nicht zu den Schlaufüchsen kommen, aber zwischen dem 30.06. und 30.09. 6 Jahre alt werden?
- Frau Mandel: Es wird individuelle Gespräche mit den betreffenden Eltern und ggf. Einzelfallentscheidungen geben.

b) Stand Planung Elternversammlungen

- Ein Treffen draußen wäre aufgrund der Inzidenzzahlen möglich
- Die Planungen dazu laufen in Verbindung mit Eltern-Kind-Nachmittagen und der oben angesprochenen Neubau-Begehung
- Ggf. beides veranstalten: TelKo und Eltern-Kind-Nachmittag

c) Planung Kita-Ausschuss 17.06.



- Verschoben auf 22.06.
- Idee: Pizza bestellen

Der nächste Ausschuss findet am 22.06.2021, 18 Uhr in der Kita statt.

Anwesenheitsliste 20.05.2021

Frau Mandel	Leitung
Frau Schulze	Träger
Simone H.	Kita-Ausschuss-Vorsitzende, EV Sonnenkäfer
Andreas W.	Märchenland, stellv. Kita-Ausschuss-Vorsitz
Andreas K.	EV Schlaufüchse
Linda H.	EV Rasselbande, stellv. EV Märchenland, FöVe
Matthias K.	EV Kobolde
Ulrike H.	stellv. EV Rasselbande
Daniela G.	stellv. EV Sonnenkäfer
Isabelle T.	stellv. EV Wichtel
Matthias K.	EV Kobolde
Julia N.	stellv. EV Kobolde
Theres W.	EV Wichtel, FöVe
Teresa H.	Erz. Märchenland
Sarah G.	Erz. Schlaufüchse
Britta S.	Erz. Rasselbande
Nora D.	Erz. Kobolde
Max L.	Erz. Wichtel

Personalplanung ab 12.07.2021

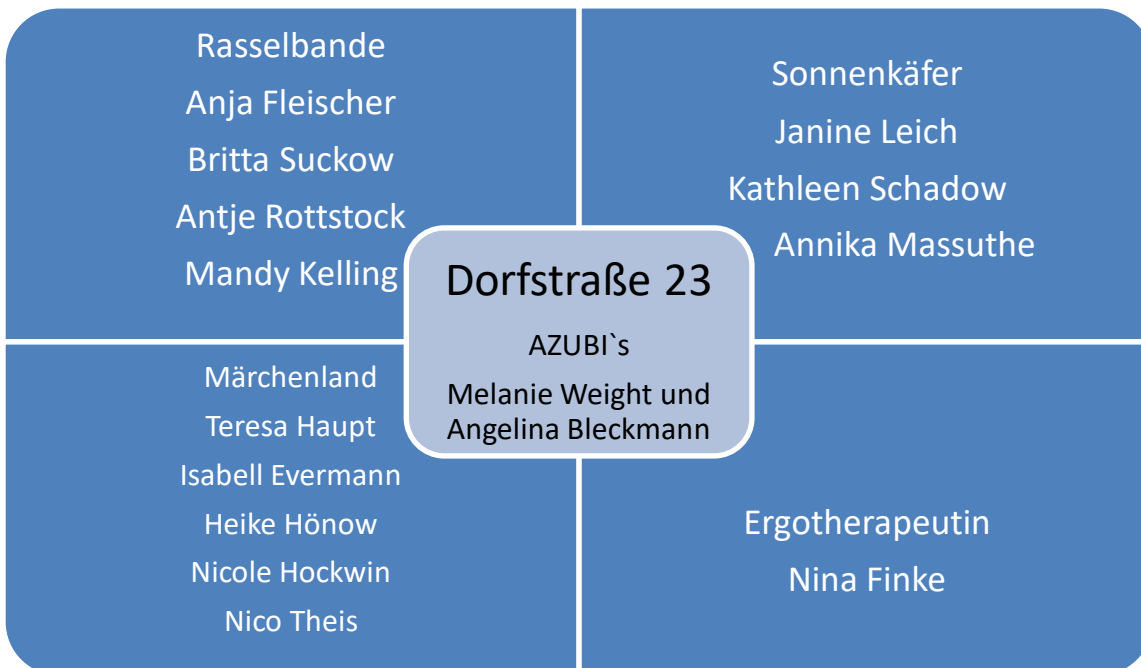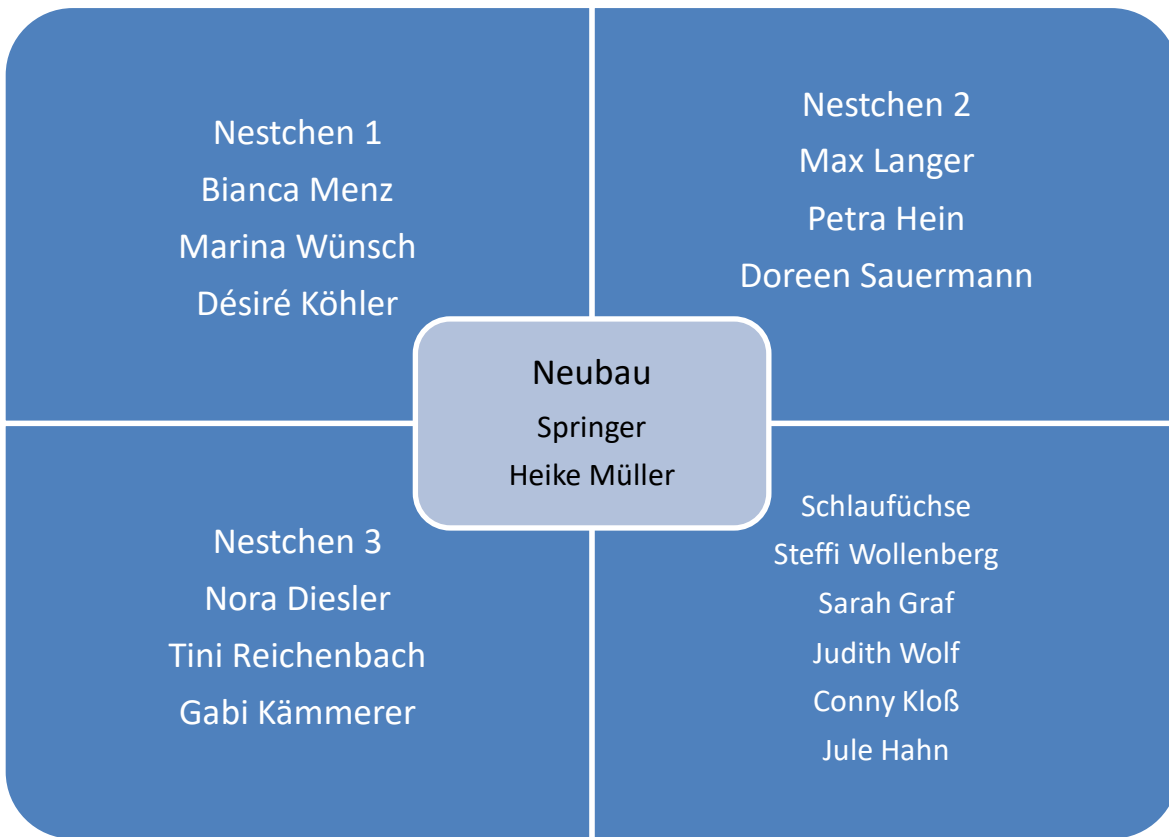

NADAL®



COVID-19 Ag Test

Antigen-Schnelltest zur Eigenanwendung zum Nachweis des COVID-19-Erregers SARS-CoV-2 in nasalen Abstrichproben

REF 243103N-05H

LOT 175387



2023-03

Nicht einnehmen


Für Kinder unzugänglich aufbewahren

Inhalt ausreichend für 5 Untersuchungen

Test zur Eigenanwendung - Befristete Sonderzulassung

zur Eigenanwendung nach §11 MPG in Deutschland

(BfArM GZ: 5640-S-045/21)

 nal von minden GmbH
Carl-Zeiss-Straße 12,
47445 Moers-Germany



Rev01.01



NADAL®

COVID-19 Ag Test

Gebrauchsanweisung

Antigen-Schnelltest zur Eigenanwendung zum Nachweis des COVID-19-Erregers SARS-CoV-2 in nasalen Abstrichproben

- Schnelltest
- Labordiagnostik
- Laborservice
- Beratung & Service

(Ref: 243103N-05H)

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Führen Sie den Test bei Raumtemperatur (15-30°C) durch. Dafür muss der Test zuvor 30 Minuten bei Raumtemperatur liegen. Verwenden Sie den Test nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums oder wenn Einzelbestandteile der Verpackung beschädigt sind. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von Eltern oder berechtigten Erwachsenen zu unterstützen.

Packungsinhalt



Zusätzlich benötigt



Uhr

Auch als Video-Anleitung verfügbar. Einfach diesen Code scannen.



Testdurchführung

1. Legen Sie die Röhrchenhalterung auf den Tisch. Stellen Sie das Röhrchen in die Öffnung.




2. Öffnen Sie die Ampulle. Drehen Sie dazu die Spitze ab.

3. Geben Sie die gesamte Flüssigkeit in das Röhrchen. Drücken Sie die Ampulle über dem Röhrchen zusammen.

4. Schnäuzen Sie Ihre Nase einmal kurz in ein Taschentuch.


5. Öffnen Sie die Verpackung des Tupfers. Ziehen Sie dazu die losen Enden der Verpackung auseinander. Entnehmen Sie den Tupfer am Stiel. Berühren Sie nicht die Spitze des Tupfers.

Führen Sie alle Schritte ohne Unterbrechung durch!

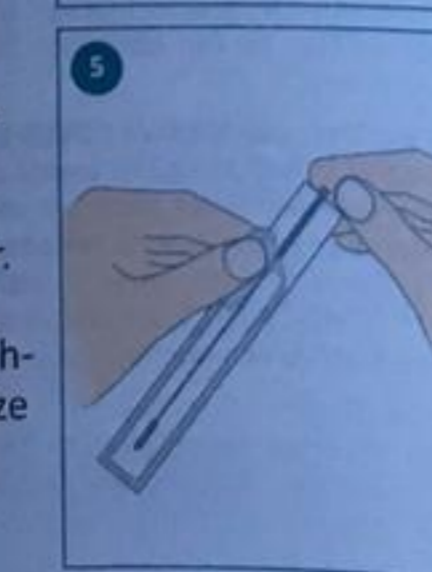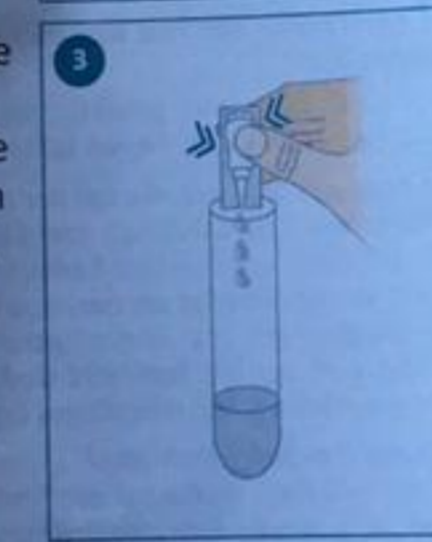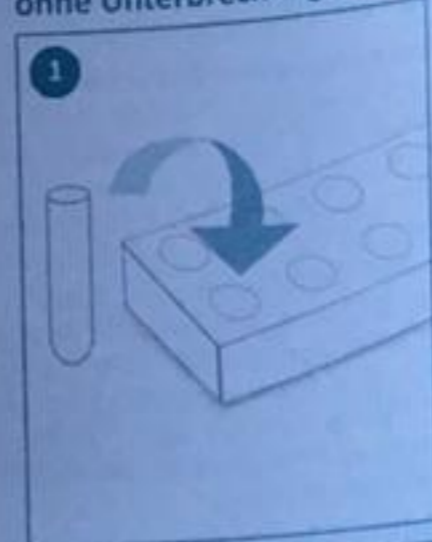


6. Probennahme


- a) Führen Sie den Tupfer etwa 2 cm in das Nasenloch ein.
- b) Drehen Sie den Tupfer 5-mal sanft gegen die Nasenwand. Der Tupfer sollte dabei 15 Sekunden im Nasenloch verbleiben.
- c) Ziehen Sie den Tupfer unter leichtem Drehen wieder aus der Nase heraus.
- d) Wiederholen Sie den Vorgang mit dem gleichen Tupfer im anderen Nasenloch, auch für 15 Sekunden.

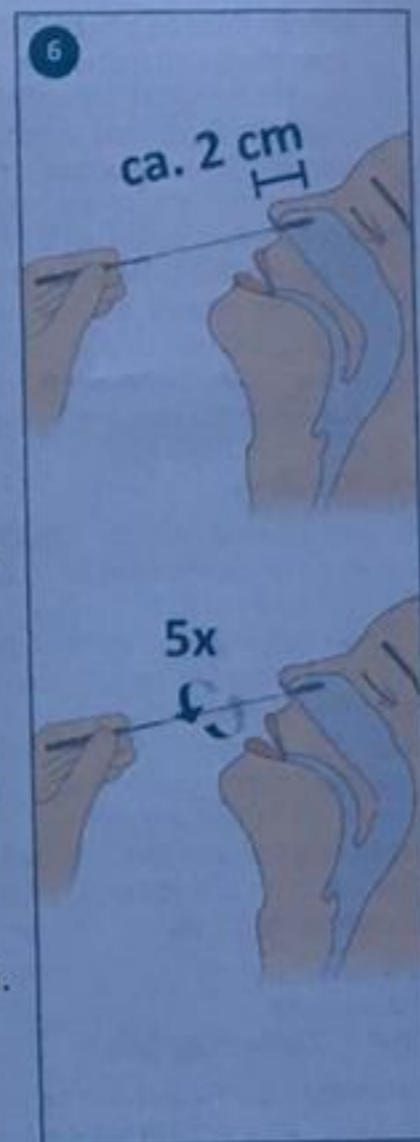


7. Stecken Sie den Tupfer in das Röhrchen. Drehen Sie den Tupfer und drücken Sie den unteren Teil des Röhrchens währenddessen 10-mal zusammen, so dass ein leichter Druck auf die Tupferspitze ausgeübt wird.

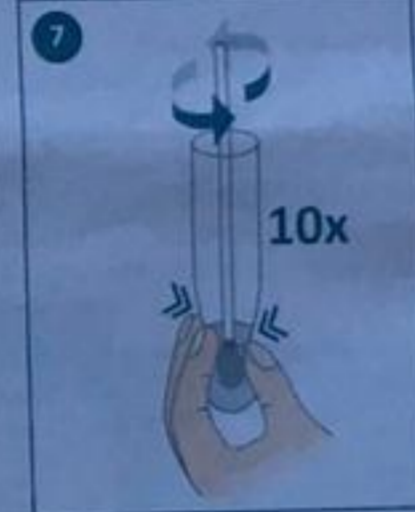

8. Entnehmen Sie den Tupfer. Drücken Sie das Röhrchen dabei zusammen, um so viel Flüssigkeit wie möglich aus dem Tupfer auszudrücken.

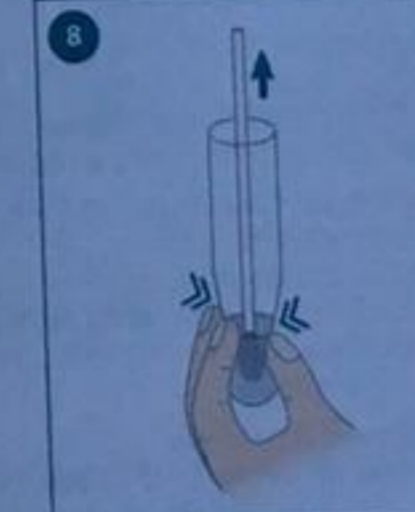

9. Setzen Sie den Tropfaufsatz auf das Röhrchen. Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

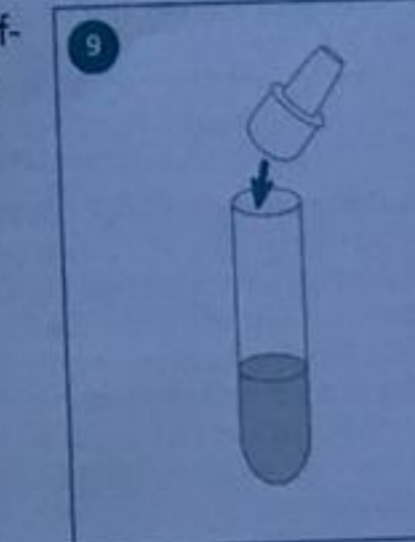


10. Öffnen Sie den Folienbeutel und entnehmen Sie die Testkassette. Legen Sie die Testkassette auf eine saubere und ebene Oberfläche. Geben Sie 3 Tropfen der Flüssigkeit durch leichtes Drücken in das runde Probenfeld (S) der Testkassette (NICHT in das längliche Ergebnisfeld).
11. Schauen Sie auf die Uhr. Nach 15 Minuten können Sie das Ergebnis ablesen! Nach mehr als 20 Minuten ist das Ergebnis nicht mehr gültig.



Testauswertung

Lesen Sie das Testergebnis bei guter Beleuchtung ab.

Negatives Testergebnis:
Im Ergebnisfeld erscheint nur die C-Linie. Es wurde kein Virus nachgewiesen, es liegt kein Hinweis auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 vor.



Achtung: Ein negatives Testergebnis schließt eine Infektion nicht aus. Halten Sie sich deswegen weiterhin an alle geltenden Regeln bzgl. Kontakt mit anderen und Schutzmaßnahmen. Im Verdachtsfall wiederholen Sie den Test nach 1-2 Tagen, da das Virus nicht in allen Phasen einer Infektion genau nachgewiesen werden kann.

Positives Testergebnis:
Im Ergebnisfeld erscheint die C-Linie und die T-Linie. Dies deutet auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 hin.



Hinweis: Die Intensität der T- oder C-Linie kann unterschiedlich sein. Auch eine sehr schwache oder unregelmäßige T-Linie ist ein positives Testergebnis!

Achtung: Kontaktieren Sie sofort telefonisch Ihren Hausarzt oder das örtliche Gesundheitsamt, da das Ergebnis mit einem PCR-Test bestätigt werden muss. Halten Sie die örtlichen Richtlinien zur Selbstisolierung ein.

Ungültig:

Es erscheint keine C-Linie. Das Ergebnis ist ungültig und deutet auf eine fehlerhafte Testdurchführung hin.



Achtung: Bitte führen Sie einen neuen Test durch. Bei weiterhin ungültigen Ergebnissen kontaktieren Sie Ihren Arzt oder ein COVID-19-Testzentrum.

